




Agilent Bravo と BioTek Synergy によるサンプルの正規化の自動化

生産性向上と長時間の無人運転を実現しつつ、サンプル前処理の精度と再現性を向上

Bravo Liquid Handler

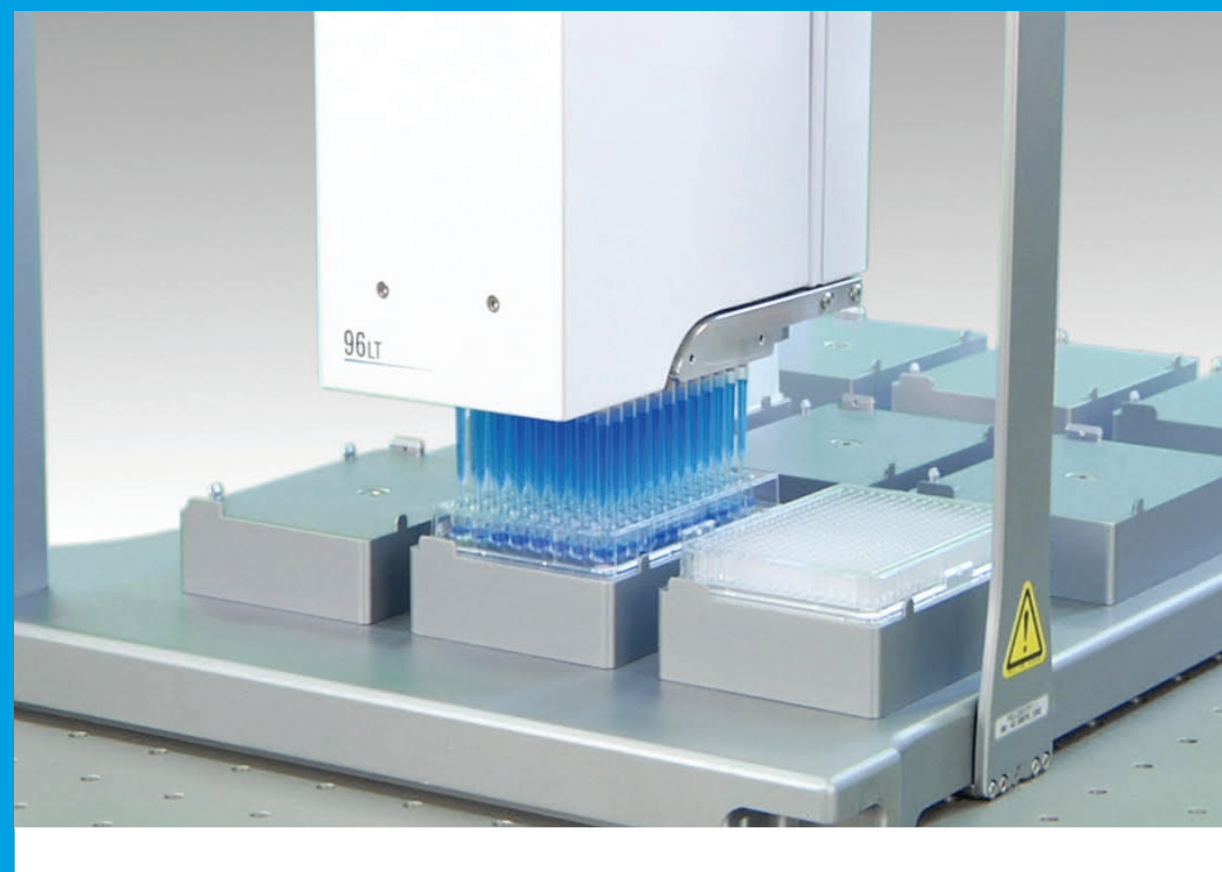

BioTek Synergy Reader

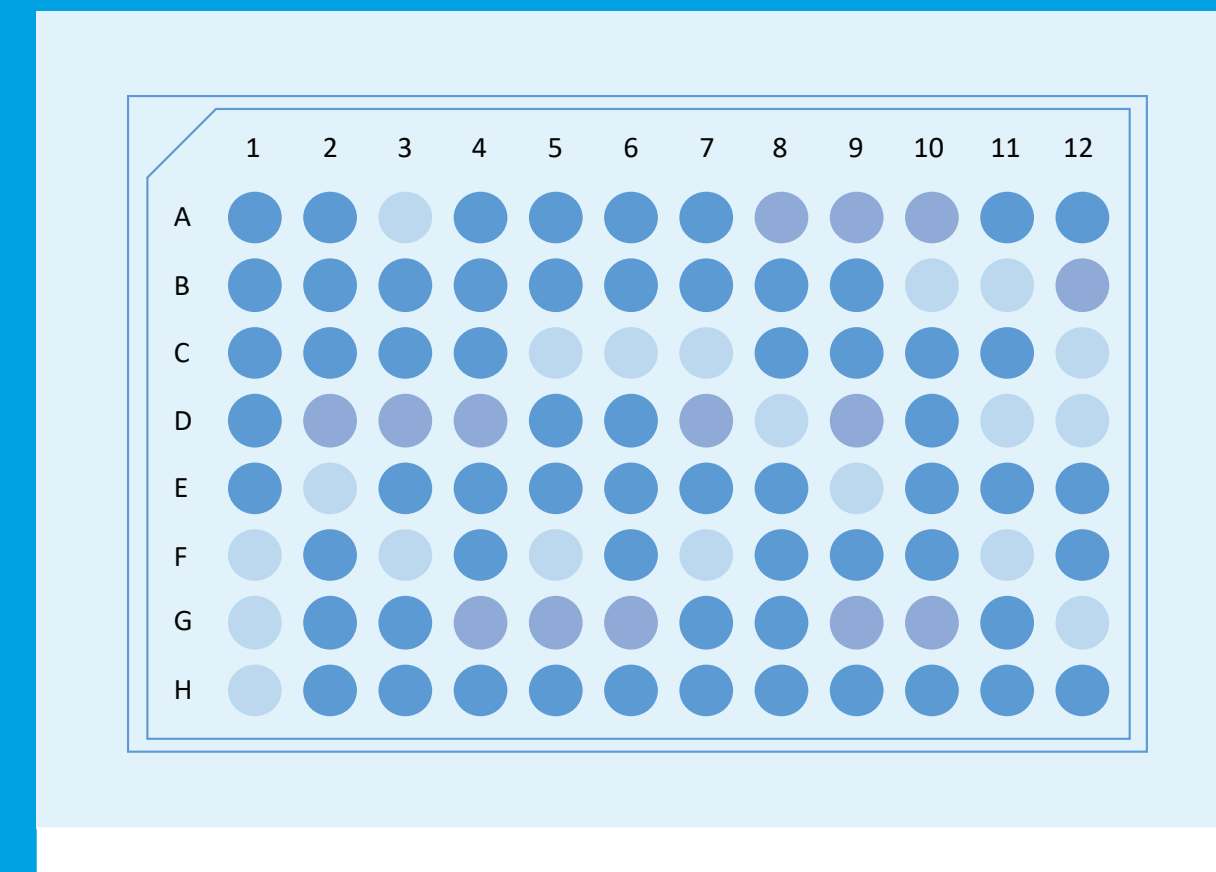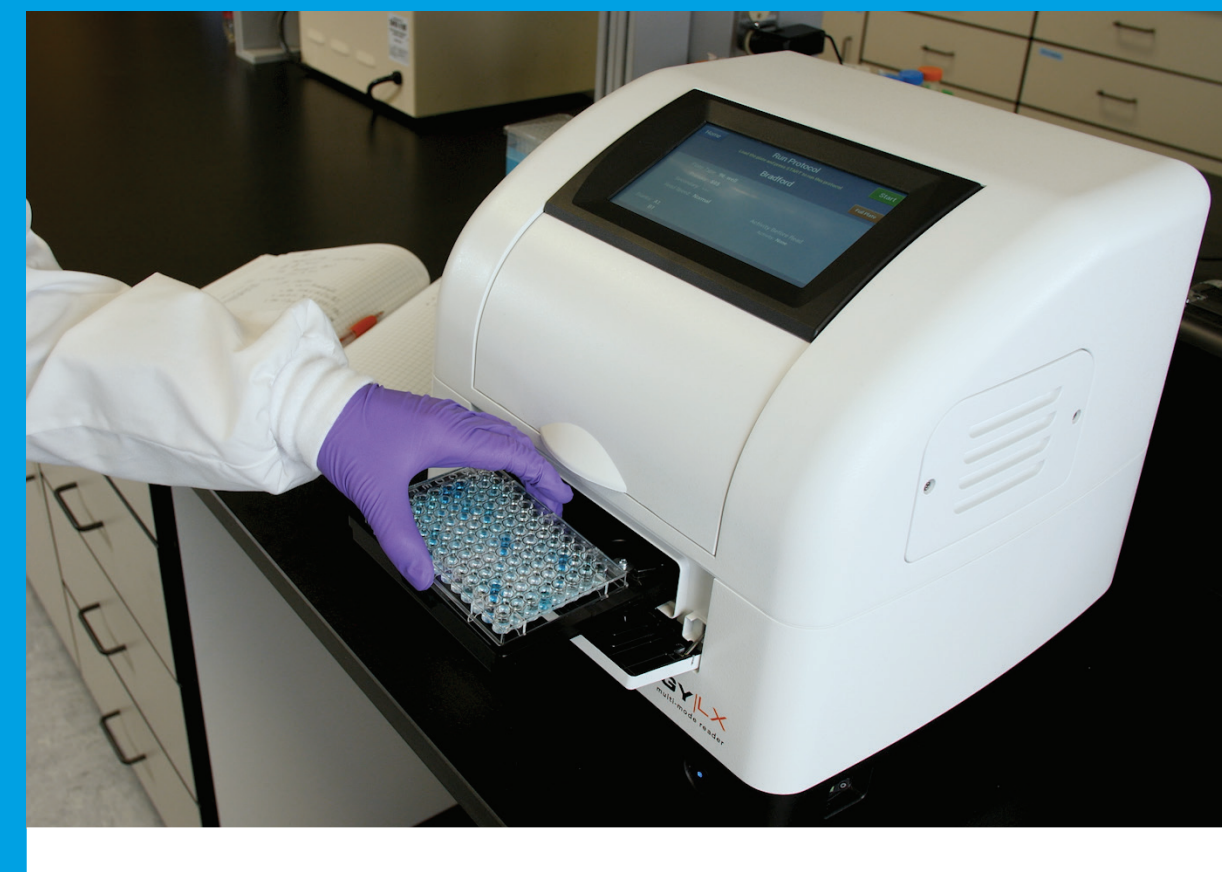

Bravo Liquid Handler



サンプルの前処理
RNA、DNA、タンパク質

サンプルの測定
A₂₆₀、A₂₈₀、蛍光

サンプルの値のリンク
濃度値の自動計算
およびリンク


サンプルの正規化
自動生成された
正規化プロトコルの実行



組み合わせることで相乗効果を発揮します。

新たな発見につながる技術の詳細はホームページで

www.agilent.us/chem/agilent-bravo-biotek-synergy

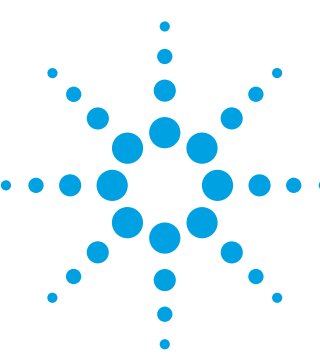 **Agilent**
Trusted Answers

ホームページ
www.agilent.com/chem/jp

カスタマコンタクトセンター
0120-477-111
email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の仕様、説明、製品仕様等は予告なしに
変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2020
Printed in Japan, May 20, 2020
5994-1975JA-0P
DE 3591782407